

# VESTNÍK



**MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

---

Čiastka 40-44

Dňa 12. decembra 2014

Ročník 62

---

## **OBSAH:**

### **Normatívna časť:**

32. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchranej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL

**32.****Výnos  
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky****z 26. novembra 2014,  
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  
z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o  
záchranej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchranej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2008 Z. z. ustanovuje:

**Čl. I**

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchranej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.) v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL (oznámenie č. 338/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa vypúšťajú slová „upravenej aj pre transport inkubátora“.
2. V § 4 sa slová „strediska tiesňového volania záchranej zdravotnej služby“ nahrádzajú slovami „strediska tiesňového volania záchranej zdravotnej služby (ďalej len „operačné stredisko“).
3. Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6d, ktoré znejú:

**„§ 6a**

Vzor evidenčného listu zásahových skupín, ak ide o nehodu s hromadným postihnutím osôb, je uvedený v prílohe č. 7.

**§ 6b**

Vzor evidenčného listu ošetrovaných osôb, ak ide o nehodu s hromadným postihnutím osôb, je uvedený v prílohe č. 8.

**§ 6c**

Vzor evidenčného listu transportovaných osôb, ak ide o nehodu s hromadným postihnutím osôb, je uvedený v prílohe č. 9.

**§ 6d**

Vzor evidenčného listu vytriedených osôb, ak ide o nehodu s hromadným postihnutím osôb, je uvedený v prílohe č. 10.“

4. V § 7 ods. 2 sa za slovo „technické“ vkladajú slová „a personálne“.

5. V § 7 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:  
„c) zdravotníkmi pracovníkmi podľa prílohy č. 3,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

6. V § 7a ods. 1 sa slová „operačnom stredisku tiesňového volania záchranej zdravotnej služby“ nahrádzajú slovami „operačnom stredisku“.
7. V § 7a ods. 1 písm. b sa slová „operačné stredisko záchranej zdravotnej služby“ nahrádzajú slovami „operačné stredisko“.
8. V prílohe č. 1 sa v nadpise vypúšťajú slová „V RÁMCI ZÁSAHOVÉHO OBVODU KOORDINAČNÉHO STREDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU“.
9. V prílohe č. 1 časti B. písm. a) treťom bode sa za slovo „podporuje“ vkladá slovo „centralizované“.
10. V prílohe č. 1 časti B. písm. a) sa vypúšťa piaty bod.  
  
Doterajší šiesty a siedmy bod sa označuje ako piaty a šiesty bod.
11. V prílohe č. 1 časti B. písm. b) tretí a štvrtý bod znie:  
„3. umožňuje centrálné riadenie a monitoring príjmu tiesňového volania bez ohľadu na fyzické umiestnenie operátora a operačného strediska,  
4. umožňuje automatické, bezodkladné presmerovanie prevádzky medzi jednotlivými operátormi a medzi operačnými strediskami na základe prednastavených prevádzkových stavov v spojitosti s momentálnou obsadenosťou operátorov v rámci celej Slovenskej republiky,“.
12. V prílohe č. 1 časti B. sa písm. b) dopĺňa piatym až ôsmym bodom, ktoré znejú:  
„5. umožňuje centralizovaný záznam hlasovej komunikácie operátora s možnosťou okamžitého prehrania situácie,  
6. umožňuje pripojenie digitálnych a analógových liniek, podporuje technológiu VoIP,  
7. umožňuje dynamicky v reálnom čase meniť úlohu operátora na základe okamžitých potrieb operačného strediska,  
8. umožňuje okamžite bez ohľadu na fyzické umiestnenie operátora v rámci Slovenskej republiky smerovať núdzové volania operátorovi operačného strediska, ktorý je lekár a ovláda niektorý zo svetových jazykov;“.
13. V prílohe č. 1 časti B. písmene c) sa vypúšťa piaty bod.
14. V prílohe č. 1 časti B. písmene e) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:  
„2. umožňuje názornú vizuálnu a grafickú podporu operačného riadenia a informácií pre operátorov v jednotlivých operačných strediskách,“.

Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.

15. V prílohe č. 1 časti C. písmeno a) znie:

"a) operátor operačného strediska, ktorý nie je lekár ale je zdravotnícky pracovník. V jednej zmene sú minimálne dvaja operátori operačného strediska  
1. zdravotnícky záchranár alebo  
2. zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby".

16. V prílohe č. 1 časti C. písmene b) sa slová „na cca 600 000 až 1 300 000 obyvateľov“ nahrádzajú slovami „na 1 500 000 až 2 000 000 obyvateľov na určenom pracovisku“.

17. V prílohe č. 2 časti A. písmene e) sa vypúšťajú slová „upravenej aj pre transport inkubátora“.

18. V prílohe č. 2 časti A. písmene j) sa slovo „Leteckého“ nahrádza slovom „Dopravného“.

19. V prílohe č. 2 časti A. písmene k) sa slová „ak je stanicou“ nahrádzajú slovami „ako súčasť stanice“.

20. V prílohe č. 2 časti B. sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:  
„c) technické vybavenie za účelom systematického zberu medicínskych štatistických dát,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

21. V prílohe č. 3 časti I písm. A, bodoch 1 až 4, sa slová "normy STN EN 1789" nahrádzajú slovami „podľa technickej normy<sup>1)</sup>"

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) STN EN 1789+A1 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie (Konsolidovaný text) (84 7080).“.

22. V prílohe č. 3 v časti I. časti A. štvrtom bode sa vypúšťajú slová „upravenej aj pre transport inkubátora“.

23. V prílohe č. 3 v časti I. sa časť A. dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:  
„5. prostriedky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií o polohe a stave vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.

24. V prílohe č. 3 časti I. časť B. prvý bod znie:

„1. schválenie Dopravným úradom Slovenskej republiky<sup>2)</sup> upravené na transport ležiacich alebo sediacych pacientov. Ďalšia modifikácia je možná podľa účelu použitia a schválenia Dopravným úradom Slovenskej republiky, ak nie je ustanovené inak pre daný typ použitej leteckej techniky. Rádiokomunikačné zariadenia umožňujú dorozumievanie na všetkých frekvenciách používaných v leteckej doprave, záchrannej zdravotnej službe, v Horskej záchrannej službe a v hasičskom a záchrannom zbore na celom území Slovenskej republiky,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z. 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.03.2008) v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z

5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012) v platnom znení.“.
25. V prílohe č. 3 v časti I. časti B. druhom bode sa slová „výsadok záchranára“ nahrádzajú slovami „možnosť realizácie výsadku záchranára alebo lekára“.
26. V prílohe č. 3 v časti I. sa časť B. dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:  
„3. prispôsobenie paluby vrtuľníka pre použitie okuliarov na nočné videnie.“.
27. Príloha č. 3 časť II. znie:
- „II. Špecifické materiálo-technické vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií záchranej zdravotnej služby

Špecifické materiálo - technické vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií záchranej zdravotnej služby		Typ ambulancie			
set	položka setu	RZP	RLP	RLP/MIJ	VZZS
a) vybavenie slúžiace na operačné riadenie, koordináciu a prenos informácií (príslušné technické prostriedky dodá OS ZZS SR)	1. ručný rádiový terminál umožňujúci komunikáciu v rádiotelekomunikačnej sieti SITNO	X	X	X	X
	2. vozidlový rádiový terminál umožňujúci komunikáciu v rádiotelekomunikačnej sieti SITNO	X	X	X	
b) vybavenie na prepravu pacienta-transportná technika	1. polohovateľné nosidlo so sklopným odnímateľným polohovacím podvozkom a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta - odporúčané s nosnosťou minimálne 150 kg (pre VZZS - polohovateľné nosidlo bez sklopného polohovacieho podvozku -odporúčané s nosnosťou minimálne 120 kg)	X	X	X	X
	2. plošina pod nosidlá s nájazdom	X	X	X	
	3. transportné kreslo, alebo transportná sedačka upravená na transport po schodoch a nerovnom teréne (schodolez)	X	X	X	
	4. vákuový matrac	X	X	X	X
	5. dlhá chrbticová doska s príslušenstvom na fixáciu hlavy a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta	X	X	X	
	6. transportná plachta (viacručná)	X	X	X	X
	7. prikrývka na zakrytie pacienta, termofólie	X	X	X	X
	8. fixačný transportný systém pre transport ranených a chorých detí	X	X	X	X

c) vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice	1. súprava na znehybnenie zlomenín kostí pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov	X	X	X	X
	2. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov 3 ks a jeden univerzálny nastaviteľný prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice	X	X	X	
	3. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov 1 ks a jeden univerzálny nastaviteľný prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice				X
	4. trojrohá šatka 3 ks	X	X	X	X
	5. krátka chrbticová doska alebo Kendrickova vyslobodzovacia vesta	X	X	X	X
d) vybavenie na starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie	1. stacionárne tlakové nádoby na medicínalný kyslík s minimálnym množstvom 2000 l (pri normálnej teplote a tlaku okolia), s redukčným ventilom a prietokomerom s maximálnym prietokom 15 l/ min., odberové miesto je v ambulatnom priestore cez rýchlospojky	X	X	X	
	2. prenosné tlakové nádoby na medicínalný kyslík s minimálnym množstvom 400 l (pri normálnom tlaku okolia a teplote) s redukčným ventilom a prietokomerom s maximálnym prietokom minimálne 15 l/min.	X	X	X	
	3. stacionárne tlakové nádoby na medicínalný kyslík s minimálnym množstvom 800 l (pri normálnej teplote a tlaku okolia) s redukčným ventilom a prietokomerom maximálnym prietokom 15 l/min., odberové miesto je v ambulatnom priestore cez rýchlospojky a prenosné tlakové nádoby s kyslíkom a minimálnym množstvom 200 l (pri normálnej teplote a tlaku okolia) s redukčným ventilom a prietokomerom s maximálnym prietokom min. 15 l/ min.				X
	4. dýchací samorozpínací vak s kyslíkovým rezervoárom, možnosťou pripojenia na kyslíkové, zaradenia PEEP ventilu, na tvárové masky pre všetky vekové skupiny, na koncovky supraglotickej pomôcky a kanyly na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest	X	X	X	X

	5. samostatný ventil na regulovaný pozitívny tlak na konci výdychu (PEEP ventil) s možnosťou pripojenia na dýchací vak, vrátane zaradenia do dýchacieho okruhu pri UVP (napojenia na koncovku supraglotickej pomôcky a kanyly na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	X	X	X	
	6. vybavenie na inhaláciu kyslíka pre všetky vekové kategórie	X	X	X	X
	7. prenosná odsávačka s možnosťou regulácie odsávacieho tlaku pre všetky vekové kategórie	X	X	X	X
e) vybavenie na starostlivosť o krvný obeh	1. kanyly na vstup do žilového systému pre všetky vekové kategórie, striekačky, infúzne súpravy, spojovacie hadičky, kohútiky	X	X	X	X
	2. vybavenie na intraoseálny prístup pre deti aj dospelých	X	X	X	X
	3. zariadenie na zohrievanie infúzných roztokov			X	
	4. držiaky na infúzne fľaše	X	X	X	X
	5. výbava na pretlakovú infúziu	X	X	X	X
	7. adhezívny fixačný materiál (napr. leukoplast)	X	X	X	X
f) vybavenie na základnú diagnostiku	1. tlakomer s manžetami pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov	X	X	X	X
	2. pulzný oxymeter s opciou pre všetky vekové kategórie, ak nie je súčasťou iného zariadenia	X	X	X	X
	3. fonendoskop	X	X	X	X
	4. teplomer	X	X	X	X
	5. diagnostická lampa	X	X	X	X
	6. glukomer	X	X	X	X
g. 1.) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy - prístroje, zariadenia na obnovu a podporu vitálnych funkcií (činnosť srdca a pod.)	1. transportný defibrilátor s možnosťou automatickej alebo poloautomatickej externej defibrilácie a s možnosťou defibrilácie detí, so zobrazením a fyzickým 12- zvodovým záznamom EKG krivky pacienta s možnosťou pripojenia do elektrickej siete v ambulantnej časti vozidla alebo priebežného dobíjania batérií v ambulancii ZZS	X	X	X	X
	2. externý kardiostimulátor samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia		X	X	X

	3. monitorovacie zariadenie s možnosťou neinvazívneho a invazívneho sledovania životných funkcií (ventilácia, oxygenácia, hemodynamika, ) s možnosťou napojenia a dobíjania batérií v ambulancii ZZS, ak nie je súčasťou iného zariadenia			X	
g.2.) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy - prenosná súprava na základnú / rozšírenú neodkladnú podporu životných funkcií	1. tvárové masky s možnosťou pripojenia na prívod kyslíka, pre všetky vekové kategórie	X	X	X	X
	2. vzduchovody pre všetky vekové kategórie	X	X	X	X
	3. tvárová maska s možnosťou nebulizačnej liečby pre všetky vekové kategórie	X	X	X	X
	4. katéter na odsávanie z dýchacích ciest, pre všetky vekové skupiny	X	X	X	X
	5. Magilové kliešte pre dospelých a deti	X	X	X	X
	6. vodič pre zavedenie intubačnej kanyly, pre všetky vekové skupiny		X	X	X
	7. laryngoskop s vhodnými lyžicami pre všetky vekové kategórie	X	X	X	X
	8. intubačné kanyly pre všetky vekové kategórie		X	X	X
	9. supraglotická pomôcka na alternatívne zaistenie DC pre všetky vekové kategórie	X	X	X	X
	10. pomôcky na fixáciu endotracheálnych kanýl a supraglotických pomôcok	X	X	X	X
	11. set na koniotómiu alebo koniopunkciu pre dospelých aj deti		X	X	X
	12. nasogastrické alebo gastrické sondy pre všetky vekové kategórie	X	X	X	X
	13. súpravy na punkciu a drenáž hrudníka (PNO)		X	X	X
	14. hrudný drenážny systém na aktívnu sukciu			X	
	15. dávkovač infúzných roztokov (volumetrická infúzna pumpa)			X	
	16. lineárny dávkovač liekov 1 ks		X		
	17. lineárny dávkovač liekov 2 ks			X	X
	18. transportný automatický dýchací prístroj s programom na riadené dýchanie a s ventilom na nastavenie pozitívneho tlaku na konci výdychu s možnosťou regulovania frakcie inšpirovaného kyslíka a monitorovania tlaku v dýchacích cestách		X		



	19. automatický dýchací prístroj určený pre všetky vekové skupiny vrátane detí (s výnimkou novorodencov a extrémne nezrelých novorodencov transportovaných v inkubátore) s programom na riadené, podporné dýchanie, s možnosťou nastavenia pozitívneho tlaku na konci výdychu a režimom na ventiláciu so stálym pozitívnym tlakom v dýchacích cestách a s plynulou reguláciou frakcie inšpirovaného kyslíka			X	
	20. automatický dýchací prístroj s programom na riadené a podporné dýchanie s ventilom na nastavenie pozitívneho tlaku na konci výdychu s možnosťou plynulého regulovania frakcie inšpirovaného kyslíka a monitorovania tlaku v dýchacích cestách				X
	21. automatický dýchací prístroj určený pre novorodencov vrátane extrémne nezrelých novorodencov vhodný pre transport nezrelého novorodenca s programom na riadené, podporné dýchanie a s režimom na ventiláciu so stálym pozitívnym tlakom v dýchacích cestách s možnosťou nastavenia pozitívneho tlaku na konci výdychu s plynulou reguláciou frakcie inšpirovaného kyslíka, od 0,2 do 1 FiO <sub>2</sub> , odporúčané s aktívnym zvlhčovaním a vyhrievaním inšpirovaných zmesí, pokiaľ nie je súčasťou transportného inkubátora v zmysle bodu 24 (platí pre stanice Bratislava, Banská Bystrica a Košice)				X
	22. transportný inkubátor pre novorodenca spĺňajúci požiadavky technickej normy STN EN 60601-2-20 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-20: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských transportných inkubátorov (36 4800); (platí pre stanice Bratislava, Banská Bystrica a Košice)				X
	23. kapnometer samostatne alebo ako súčasť iného zariadenie			X	X
	24. transportný monitor vitálnych funkcií samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia (minimálne EKG krivka, neinvazívny tlak krvi, pulzný oxymeter)		X	X	X

h) vybavenie liekmi - minimálne požiadavky	1. adenozin inj.		X	X	X
	2. adrenalin inj.	X	X	X	X
	3. tramadol inj.	X	X	X	
	4. metamizol inj.	X	X	X	X
	5. flumazenil inj.		X	X	X
	6. diazepam inj., tbl. a sol. rec.	X	X	X	
	7. atropin inj.	X	X	X	X
	8. betablokátor inj.		X	X	X
	9. butylskopolamín inj.		X	X	
	10. calcium gluconicum inj. alebo calcium chloratum inj.		X	X	X
	11. cefotaxim inj.		X	X	X
	12. amiodaron inj.	X	X	X	X
	13. metoklopramid inj.		X	X	X
	14. kortikoid inj.	X	X	X	X
	15. kyselina acetylsalicylová tbl.	X	X	X	X
	16. antihistaminikum inj.	X	X	X	X
	17. urapidil inj.		X	X	X
	18. furosemid inj.	X	X	X	X
	19. glukóza monohydrát 40% inj.	X	X	X	X
	20. antipsychotikum inj.		X	X	
	21. heparin inj.	X	X	X	X
	22. izosorbitdinitrát inj.		X	X	X
	23. MgSO4 10% inj.	X	X	X	X
	24. trimekaín inj.		X	X	X
	25. midazolam inj.		X	X	X
	26. naloxon inj.		X	X	X
	27. NaCl 0,9 % inj., sol.inf.	X	X	X	X
	28. nitrát aerodisperzia	X	X	X	X
	29. noradrenalin inj.		X	X	X
	30. drotaverin inj.	X	X	X	
	31. kyselina boritá, benzododecíniumbromid, očná roztoková instilácia	X	X	X	
	32. paracetamol supp.	X	X	X	
	33. antiagreganciá trombocytov tbl. (okrem kyseliny acetylsalicylovej)	X	X	X	X
	34. propofol inj.		X	X	X
	35. prednizon supp.	X	X	X	
	36. SCHJ inj.		X	X	X
	37. nedepolarizujúce myorelaxans inj.		X	X	X
	38. aminofylín inj.		X	X	X
	39. dopamin inj.		X	X	X
	40. kaptopril tbl.	X	X	X	
	41. thiopental inj.		X	X	X
	42. ketamín inj.		X	X	X
	43. inhalačné bronchodilatans - nebulizovateľný roztok	X	X	X	X
	44. adsorbčné uhlie tbl. alebo plv.	X	X	X	X
	45. morfin a iné opioidné analgetikum inj.		X	X	X

	46. antiemetikum inj.	X	X	X	X
	47. koloidný roztok sol. inf.		X	X	X
	48. dezinfekčný roztok	X	X	X	X
i) vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrovanie	1. pomôcky na ošetrovanie rán a zastavenie krvácania (mechanické, absorpčné a iné)	X	X	X	X
	2. súprava na ošetrovanie popálenín a poleptania s aktívnou zložkou a antiseptickým účinkom (minimálny rozsah: tvár, ruky, genitálie)	X	X	X	X
	3. súprava na vedenie pôrodu	X	X	X	X
	4. vybavenie na ošetrovanie a transport replantátu	X	X	X	X
	5. emitné misky, vrecká na vracanie	X	X	X	X
	6. fľaša na moč (nie zo skla) pre mužov	X	X	X	
	7. fľaša na moč (nie zo skla), pre ženy alebo podložná misa	X	X	X	
	8. vybavenie na zber odpadu; zvlášť na ostré predmety	X	X	X	X
	9. sterilné jednorazové rukavice	X	X	X	X
	10. nesterilné jednorazové rukavice	X	X	X	X
	11. jednorazové návleky na nosidlá a prikrývky	X	X	X	X
j) vybavenie inými pracovnými prostriedkami	1. osobná čelová lampa, pre každého člena posádky zvlášť	X	X	X	X
	2. prenosný zdroj svetla	X	X	X	X
	3. hasiaci prístroj	X	X	X	X
	4. nôž (nožnice) na vyslobodenie z bezpečnostných pásov	X	X	X	X
	5. záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby	X	X	X	X
	6. doska na písanie	X	X	X	X
	7. pero	X	X	X	X
k) vybavenie osobnými ochrannými prostriedkami	1. ochranné pracovné oblečenie podľa príslušnej platnej normy ako aj jeho reflexné označenie podľa normy STN EN ISO 20471 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky (ISO 20471) (83 2722)	X	X	X	X
	2. ochranná obuv	X	X	X	X
	3. pracovné rukavice	X	X	X	X
	4. ochranné okuliare	X	X	X	X
	5. ochranná prilba s reflexnými prvkami pre každú osobu posádky zvlášť (pre VZZS so zabudovanými slúchadlami)	X	X	X	X
	6. tvárové rúško	X	X	X	X
l) vybavenie pre nehodu s hromadným postihnutím osôb	1. Reflexná vesta biela s označením „VELITEĽ ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU“ – 1 ks	X	X	X	

	2. Reflexná vesta červená s označením „VELITEĽ HNIEZDA ZRANENÝCH“ – 1 ks	X	X	X	
	3. Reflexná vesta modrá s označením „VELITEĽ ODSUNU“ – 1 ks	X	X	X	
	4. Reflexná vesta žltá s označením "TRIEDIČ" – 1 ks	X	X	X	
	5. Triediaca karta – 30 ks	X	X	X	
	6. Postup vypisovania triediacej karty 3 ks	X	X	X	
	7. pružná triediaca páska v príslušnej farbe (30 ks vo farbe červenej, 30 ks vo farbe žltej, 30 ks vo farbe zelenej, 20 ks vo farbe čiernej)	X	X	X	
	8. Ihlan pre označenie hniezda ranených 1ks; farebné návlčky 3 ks (červená, žltá a zelená farba)	X	X	X	
	9. Pre veliteľa zdravotníckeho zásahu - Evidenčný list posádok ambulancií ZZS – 2 ks	X	X	X	
	10. Pre veliteľa hniezda ranených – Evidenčný list pacientov ošetrených v hniezde ranených - 2 ks	X	X	X	
	11. Pre veliteľa odsunu – Evidenčný list transportovaných pacientov z hniezda ranených – 2 ks	X	X	X	
	12. Doska na písanie - 3 ks	X	X	X	
	13. Pero a CD popisovač – 3 ks	X	X	X	
	14. dymovnica v počte 1 ks	X	X	X	

**Vysvetlivky :****RZP** - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci**RLP** - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci**RLP/MIJ** - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky**VZZS** - ambulancia vrtuľníkovej záchranej zdravotnej služby**X** - povinná položka vo výbave príslušného typu ambulancie**Farby triediacej pásky:**

Červená: kritický

Žltá: urgentný

Zelená: neurgentný

Čierna: mŕtvy alebo zomierajúci

“

28. V prílohe č. 3 v časti III. časti C. sa v nadpise vypúšťajú slová „upravenej aj pre transport inkubátora.“.
29. V prílohe č. 3 v časti III. časti C. sa vypúšťa bod 1.2.
30. V prílohe č. 3 v časti III. časti C. druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo ak ide o neodkladnú prepravu novorodenca, sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť“.
31. V prílohe č. 3 v časti III. časti D. sa vypúšťa celý bod 1. 2.
32. Príloha č. 3 časť III. Časť D. sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
- „4. ďalší špecialista podľa potreby na základe zváženía okolností tiesňovej výzvy alebo okolností zistených počas zásahu; v odôvodnených prípadoch (napr. NHPO, transplantačný program, zásahy v horskom teréne) môže posádku tvoriť zdravotnícky pracovník podľa časti D. bodu 1 alebo bodu 2 a pilot podľa časti D. bodu 3.“
33. V prílohe č. 4 v treťom bode písmeno a) znie:
- „a) základnú farbu karosérie bielu alebo žltú (RAL 1016)<sup>10</sup>“.
34. V prílohe č. 4 bode 5 písmene c) sa slová "normy STN EN 471+A1, 1789" nahrádzajú slovami "podľa technických noriem<sup>1</sup>)".
35. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k výnosu č. 10548/2009-OL

**TRIEDIACA KARTA**  
 Vzor triediacej karty v prípade nehody s hromadným postihnutím osôb

<b>DIAGNÓZA</b>	Vedomie	*	
	O.K.	↙	
	Dýchanie		
	O.K.	↙	
	Obeh		
	O.K.	↙	
<b>TRIEDENIE</b>	Terapia	Priorita transp.	Čakanie
	I	IIa IIb	III IV
	Terapia	Priorita transp.	Čakanie
	I	IIa IIb	III IV
Lekár			
Lekár			
<b>TERAPIA</b>	<input type="checkbox"/> O <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> Intubácia	<b>POTVRDENIE VYKONANIA</b>
	<input type="checkbox"/> Ventilačia	<input type="checkbox"/> Pleurálna drenáž	
<input type="checkbox"/> Zastavenie krvácania	<input type="checkbox"/> Infúzia		
<b>TERAPIA</b>	Lieky		
	<input type="checkbox"/> Znehybnenie	<input type="checkbox"/> Dekontaminácia	
Odd.		Transp. prostriedok	
<b>H</b>	↗ <b>DOPRAVCA</b>	*	
			☑
			Odd.
Útržok pre dopravcu Poznámky:			
☑			
<b>D</b>	↗ <b>ZZS</b>	*	
			☑
			Odd.
Útržok pre ZZS Poznámky:			
☑			


MENO		
PREZVISKO		
RODNÉ ČÍSLO		
DÁTUM NARODENIA		
BYDLISKO		
U CUDZINCA: ŠTÁT		
ZDRAV. POISŤOVŔA		
POHLAVIE	MUŽ	ŽENA
TEL.KONTAKT NA NAJBLIŽŠIEHO PRÍBUZNÉHO		
PRESNÝ POPIS MESTA NÁLEZU:		
NÁKRES		

ČAS:	GCS:	TK:	D/min.:	P/min.:	sat. %
Lieč. opatrenia:					
ČAS:	GCS:	TK:	D/min.:	P/min.:	sat. %
Lieč. opatrenia:					
ČAS:	GCS:	TK:	D/min.:	P/min.:	sat. %
Lieč. opatrenia:					

\* uvedie sa kód v súlade s pravidlami tvorby kódu triediacej karty

Pravidlá tvorby kódu triediacej karty:

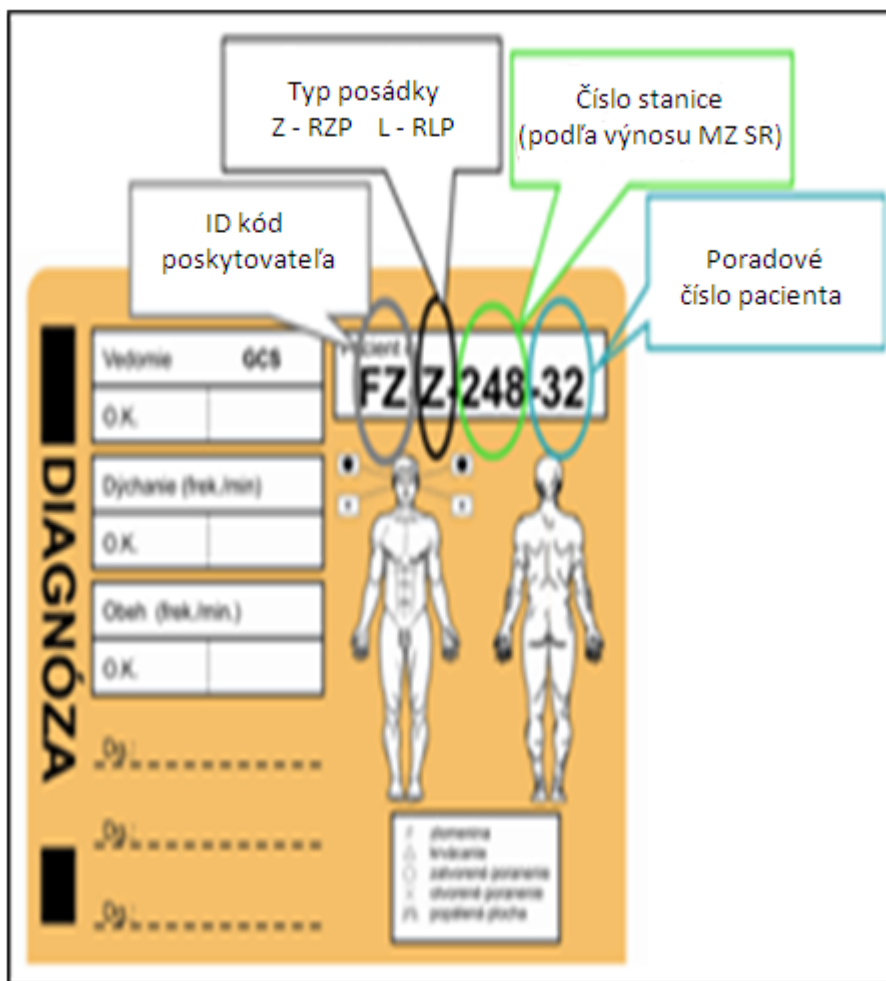

“











## Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2014.

**Viliam Čislák, v. r.**  
**minister**





**VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR**

---

Vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR vo V OBZOR, s.r.o., Bratislava, Špitálska 35. Tlač: V OBZOR, s.r.o. Adresa redakcie: Bratislava, Špitálska ul. 35. Objednávky na predplatné, ako aj jednorazové vybavuje V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, 811 08 Bratislava, tel./fax: 02 529 68 395, tel.: 02 529 61 251. Adresa pre písomný styk: V OBZOR, s.r.o, P.O.Box 64, 820 12 Bratislava 212, E-mail: [obzor@obzor.sk](mailto:obzor@obzor.sk), [www.obzor.sk](http://www.obzor.sk)